


micro-IDent®:

| | |
|--------------|--|
| CC | |
| Amp-C | |
| Aa | |
| Pg | |
| Pi | |
| Tf | |
| Td | |

micro-IDentplus-11®:

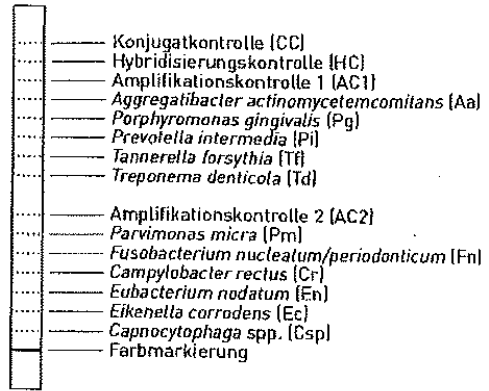

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| CC | --- | | |
| Spec-C | --- | | |
| Sens-IL-1A | --- | | |
| IL-1A-C889 | --- | | |
| IL-1A-889T | --- | | |
| Sens-IL-1B | --- | | |
| IL-1B+C3953 | --- | | |
| IL-1B+3953T | --- | | |
| Sens-IL-1RN | --- | | |
| IL-1RN+T2018 | --- | | |
| IL-1RN+2018C | --- | | |

Fehlerhafte Einsendungen:

Beschreibung: _____ Paraphe: _____

Telefonische Mitteilung: _____

Datum/Uhrzeit: _____

Name/Unterschrift des IKM-Bearbeiters: _____

Mitteilung an (Name befugte Person): _____

Beschreibung: _____

Datum, Unterschrift: